

Tychy, dn. 30.04.2013r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz sprzętu używanego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Oddziale Neonatologicznym (nr sprawy: 6/13/ZZP/PN)

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy §11 wzoru umowy

Czy wskazanie, że można udzielić pełnomocnictwa radcy prawnemu lub adwokatowi ogranicza możliwość Wykonawcy do udzielenia pełnomocnictwa jednemu adwokatowi lub radcy prawnemu czy chodzi o określenie profesji osób wykonujących usługi prawne? Co w takich sytuacjach z tzw. doradcami prawnymi (osobami świadczącymi usługi prawnicze w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej)?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis w §11 w następujący sposób, iż wykreśla ze zdania 4 słowa: „ ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata”

I otrzymuję brzmienie w całości:

„Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiegokolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania”

Pytanie nr 2 dotyczy §11 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie ograniczenia jak w § 11 proponowanej treści umowy?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pyt. nr 1.

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 118 poz. 1

Czy Zamawiający uzna za wystarczające zaoferowanie czapeczek w rozmiarach od 000 do 7?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 118 poz.2

Czy Zamawiający wymaga, aby podstawa maski nosowej była przejrzysta, co umożliwi wzrokową kontrolę drożności przepływu gazów oddechowych oraz jej właściwego położenia?

MEGREZ Sp. z o.o.

W związku z tym, że Szpital leczy dzieci przedwcześnie urodzone zachodzi konieczność stosowania masek o bardzo małym rozmiarze (dla dzieci o ekstremalnie niskiej masie urodzeniowej tj. rozm. XS). Czy Zamawiający wymaga zaoferowania takiej maski nosowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane maski i wymaga pełnej dostępnej rozmiarówki (od XS do XL).

Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 118 poz. 7

Czy Zamawiający wymaga, aby układ oddechowy posiadał generator wyposażony w 2 kanały oddechowe zapewniające zmniejszenie pracy oddechowej noworodka, poprzez zastosowanie w każdym torze oddechowym 2 dysz przyspieszających przepływ gazów? Takie rozwiązanie pozwoli zwiększyć grupę zwłaszcza bardzo słabych oddechowo wcześniaków, dla których nieinwazyjne wspomaganie oddechu metodą Infant Flow będzie wystarczające. Dzięki temu noworodki te unikną intubacji i wentylacji inwazyjnej, która powoduje wiele uszkodzeń płuc

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w zakresie Pakietu nr 100 ma na myśli materiały eksploatacyjne charakteryzujące się wysoką jakością znane i atestowane przez producenta urządzenia lub/i przez jego autoryzowanego przedstawiciela./serwis, czyli takie, które są w sposób potwierdzony stosownym oświadczeniem tych podmiotów- w pełni kompatybilne z eksploatowanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem: Medrad Stellant CT (nr seryjny 30029) i jako takie nie spowodują usterek w działaniu wstrzykiwacza, ani nie będą powodem jego uszkodzenia, jak również nie spowodują ryzyka cofnięcia udzielonych na w/w aparat gwarancji lub/i rękojmi (udzielanych standardowo po wykonanych interwencjach serwisowo-naprawczych)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 7

Czy w przypadku, jeśli potencjalni Wykonawcy nie będą dysponować stosownym oświadczeniem producenta urządzenia Medrad Stellant CT lub/i jego autoryzowanego przedstawiciela/serwisu, o pełnej kompatybilności i potwierdzonej jakości oferowanych produktów, Zamawiający w ramach Pakietu nr 100 wymagał będzie od Wykonawców oferujących zamienniki materiałów oryginalnych (tj. produkowanych przez firmę Medrad), złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o przejęciu przez niego pełnej odpowiedzialności za jakość oferowanego sprzętu jednorazowego użytku, w tym, o przejęciu kosztów ewentualnych napraw i kosztów przestoju w pracy przedmiotowego wstrzykiwacza kontrastu w sytuacji, gdyby urządzenie to uległo uszkodzeniu lub awarii w wyniku prowadzenia jego eksploatacji z zastosowaniem oferowanego sprzętu jednorazowego użytku?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 8

Wykonawca wnosi o obligatoryjny wymóg złożenia wraz z ofertą próbek oferowanych materiałów ramach Pakietu nr 100 od Wykonawców oferujących zamienniki materiałów oryginalnych (tj. produkowanych przez firmę Medrad)

Odpowiedź

Zamawiający będzie wymagał próbek w sytuacjach opisanych w SIWZ (w razie wątpliwości).

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 11, pozycji nr. 8,10 i utworzenia odrębnego zadania w celu przedstawienia konkurencyjnej oferty handlowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji z pakietu.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 w pozycji 1,2 wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych z elastycznymi mankietami wykonanymi z poliestru?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z zSIWZ.

Pytanie nr 11 dotyczy Pakietu Nr 70, zapisu części VII pkt. 2 SIWZ pkt.3 oferty przetargowej w zw. z zapisem §5 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności oferowanego przedmiotu zamówienia, mikrokuwet firmy HemoCue do oznaczania poziomu cukru u noworodków i wcześniaków – Pakiet 70 z minimum 12 miesięcy na okres 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12 dotyczy Pakietu nr 55

Wykonawca zwraca się z prośbą o umożliwienie składania oferty na poszczególne pozycje pakietu nr 55 lub wyłączenie z ww. pakietu pozycji 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 i stworzenie z nich osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13 dotyczy Pakietu nr 58

Wykonawca zwraca się z prośbą o umożliwienie składania oferty na poszczególne pozycje pakietu nr 58 lub wyłączenie z ww. pakietu pozycji 1, 2 i stworzenie z nich osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14 dotyczy Pakietu 24 poz. 7,8

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie zakończenia p[od stronie pacjenta: klamra, zatrask, wtyk bananowy?

Odpowiedź:

Chodzi o zakończenia wtyk bananowy.

Pytanie nr 15 dotyczy Pakietu nr 25 poz. 14

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie dokładnego rozmiaru papieru. Szerokość rolki w mm i długość rolki w metrach. Prosimy także o podanie modelu aparatu do którego ma być przeznaczony papier.

Odpowiedź:

Bloczek o wymiarach 112x100-150, typ kardiogram CMS 800G.

Pytanie nr 16 dotyczy Pakietu nr 94 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści w powyższej pozycji elektrody j.u. o kształcie owalnym, przy pozostałych parametrach bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający, dopuszcza.

Pytanie nr 17 dotyczy Pakietu nr 94 poz. 3,5

Czy Zamawiający dopuści w powyższej pozycji elektrody pakowane w szczelne opakowania zgrzane z czterech stron gwarantujące długi okres gwarancji, przy pozostałych parametrach bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 dotyczy Pakietu nr 94 poz. 6

Czy w powyższej pozycji Zamawiający wymaga podkładów do defibrylacji czy też elektrod do defibrylacji jak w pozycji nr 1? Jeśli Zamawiający wymaga elektrod do defibrylacji to prosimy o podanie modelu aparatu do którego mają być przeznaczone.

Odpowiedź:

Chodzi o defibrylator firmy ZOLL.

Pytanie nr 19 dotyczy Pakietu nr 94 poz. 7

Wykonawca prosi o dopuszczenie w powyższej pozycji równoważnej elektrody o średnicy 50mm, z włókniny, bez elementu do przygotowania naskórka. 5mm różnicy nie powinno stanowić żadnej różnicy w użytkowaniu elektrody.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 dotyczy projektu umowy- §5 ust. 3

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 3 na 7 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie wymiany towaru po uznaniu reklamacji do 5 dni roboczych.

Pytanie nr 21 dotyczy projektu umowy- §6 ust. 1

Wykonawca prosimy o podanie terminu zapłaty za zrealizowaną dostawę towaru.

Odpowiedź:

Zamawiający zobowiązuje się w umowie do zapłaty w terminie określonym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Termin płatności nie krótszy niż 30 dni.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający w **Pakiecie 95** wymaga szczoteczek odpowiadającym wymaganiom określonym przez Ministerstwo Zdrowia oraz aktualnym Rekomendacjom Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, zgodnie z którymi szczoteczki cytologiczne powinny posiadać wykaz badań klinicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 95** produkt równoważny, to jest szczoteczkę cytologiczną, której podstawa ma kształt prostokąta o zaokrąglonych, atraumatycznych rogach i poza tym spełnia dokładnie tę samą funkcję?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie nr 24

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający rozszerzy zapisy SIWZ w **Pakiecie 95** poprzez wymóg dopisania do Formularza cenowego dodatkowo rubryki „Nazwa handlowa” oferowanego produktu? Prośbę swą motywujemy tym, iż dodatkowa rubryka umożliwi identyfikację i weryfikację produktu podczas dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w/w pakiecie bez zmian.

Pytanie nr 25


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów SIWZ na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r. & 3 pkt. 1 oraz Dyrektywy 93/42/EWG w **Pakiecie 95** i postawi wymóg dołączenia przez Wykonawców certyfikatu CE **łącznie** z deklaracją zgodności w co umożliwi właściwą identyfikację tych konkretnych wyrobów dopuszczonych do obrotu na terytorium RP?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 26 Pakietu Nr 95, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylne szczoteczki o wymiarach zgodnych z poniższym zdjęciem?

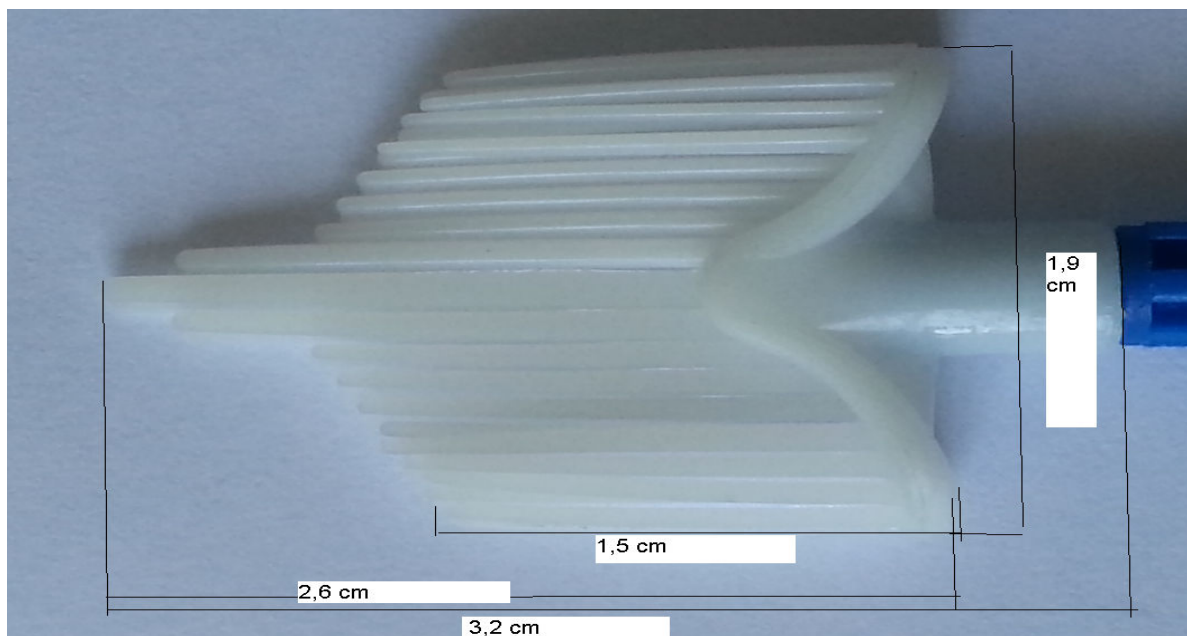

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w szczoteczki.

Pytanie nr 27 dotyczy Pakietu nr 75

Czy Zamawiający – w celu zwiększenia konkurencyjności – zgodzi się na wydzielenie pozycji 2 i 3 do osobnego pakietu lub dopuści możliwość składania ofert na poszczególne pozycje?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu..

Pytanie nr 28 dotyczy Pakietu nr 75

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści filtr infuzyjny bez zacisku szczelinowego, wyposażony w samoodpowietrzacz o przepływie 30ml/min oraz objętości wypełnienia 0,4 ml (parametry znacznie lepsze niż wymagane w SIWZ)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie nr 29 dotyczy Pakietu nr 75

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści filtr infuzyjny bez zacisku szczelinowego, wyposażony w samoodpowietrzacz, sterylizowany ETO o przepływie 120ml/1h (parametr lepszy niż wymagany w SIWZ)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie nr 30 dotyczy Pakietu nr 75

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby filtry dla łatwego i jednoznacznego rozróżnienia między wersjami dla płynów i lipidów obudowy filtrów wykonane były z materiału o różnych kolorach? Dzięki

takiemu rozwiązaniu możliwe będzie szybkie i jednoznaczne rozróżnienie poszczególnych torów infuzyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza w/w produkt.

Pytanie nr 31 dotyczy Pakietu nr 75

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowane filtry były wyposażone w krótkie przedłużki zakończone łącznikami LuerLock?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przedłużki krótkie lecz o małym wypełnieniu.

Pytanie nr 32 dotyczy Pakietu nr 107

Czy Zamawiający – w celu zwiększenia konkurencyjności – zgodzi się na wydzielenie pozycji 2 i 5 do osobnego pakietu, lub dopuści możliwość składania ofert na poszczególne pozycje?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na wydzielenie pozycji.

Pytanie nr 33 dotyczy Pakietu nr 107

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby regulator był wykonany w całości z materiału wolnego od ftalanów, i posiadał wygodny i pewny zacisk klamrowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby regulator był wykonany w całości z materiału wolnego od ftalanów, i posiadał wygodny i pewny zacisk klamrowy

Pytanie nr 34 dotyczy Pakietu nr 107

Czy zamawiający będzie wymagał, aby oferowane zestawy z regulatorem posiadały podwójną skalę rozszerzającą zakres zastosowań takich zestawów o podaż gęstszych płynów (np. lipidów)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby oferowane zestawy z regulatorem posiadały podwójną skalę rozszerzającą zakres zastosowań takich zestawów o podaż gęstszych płynów (np. lipidów).

Pytanie nr 35 dotyczy Pakietu nr 107

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby bezigłowa zastawka dostępu żylnego była wykonana z przezroczystej obudowy? Rozwiązanie takie jest znacznie bezpieczniejsze, ponieważ – dzięki przezierności – pozwala na znaczne zmniejszenie ryzyka kontaminacji wewnątrz zastawki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby bezigłowa zastawka dostępu żylnego była wykonana z przezroczystej obudowy? Rozwiązanie takie jest znacznie bezpieczniejsze, ponieważ – dzięki przezierności – pozwala na znaczne zmniejszenie ryzyka kontaminacji wewnątrz zastawki.

Pytanie nr 36

Czy w pakiecie nr 27 poz. 5 Zamawiający dopuści rozmiar 20-70 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w/w rozmiar.

Pytanie nr 37 dotyczy Pakietu nr 11 poz. 4

Wykonawca prosi o dopuszczenie czepka chirurgicznego niejałowego e formie pirackiej bandany, wiązana z tyłu, z materiału o gramaturze 25g/m² w opakowaniu a'100 szt.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 38 dotyczy Pakietu nr 15 poz. 27

Wykonawca prosi o dopuszczenie osłony na kończynę wykonanej z 2-warstwowego materiału włókna/folia. Warstwa zewnętrzna jest nieprzesiąkalna dla płynów i odporna na uszkodzenia (PE); warstwa wewnętrzna (PP z hydrofilnym wykończeniem) miękka i przyjemna dla skóry. Waga podstawowa materiału ok. 70 g/m² w rozmiarze 35 cmx120 cm plus oddzielnie pakowane taśmy samoprzylepne w ilości 200 szt.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 39 dotyczy Pakietu nr 99

Wykonawca zwraca się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycję nr 5 w przypadku wydzielenia czy Zamawiający wymaga okularków o niżej wymaganych parametrach?

1. Okularki do fototerapii j.u. dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie. Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający do minimum ryzyko podrażnienia skóry dziecka (odparzenia, alergie, wysypka). Szerokość opaski 45 mm, zapinane na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularki do każdego kształtu głowy. Dla noworodków o obwodzie główki od 20-28 cm
2. Okularki do fototerapii j.u. dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie. Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający do minimum ryzyko podrażnienia skóry dziecka (odparzenia, alergie, wysypka). Szerokość opaski 50 mm, zapinane na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularki do każdego kształtu głowy. Dla noworodków o obwodzie główki od 24-33 cm
3. Okularki do fototerapii j.u. dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie. Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający do minimum ryzyko podrażnienia skóry dziecka (odparzenia, alergie, wysypka). Szerokość opaski 60 mm, zapinane na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularki do każdego kształtu głowy. Dla noworodków o obwodzie główki od 30-38 cm

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 5 z pakietu nr 99.

Pytanie nr 40 dotyczy pakietu nr 117

Wykonawca zwraca się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji nr 1,2,10. Wydzielenie tych pozycji pozwoli na wystartowanie wyłącznemu dystrybutorowi firmy Fisher&Paykel a tym samym ograniczy koszt zakupu sprzętu medycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 117.

Pytanie nr 41 dotyczy pakietu nr 118

Wykonawca zwraca się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 118 pozycji nr: 1,2,3,5,6,7,8,11 i utworzenie oddzielnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 118.

Pytanie nr 42 dotyczy pakietu nr 118 do pozycji nr 3

Czy Zamawiający dopuści końcówki donosowe (rozmiary odznaczone kolorem jednym przejrzystym). Rozmiar S,M,L?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w końcówek. Potrzebne są końcówki donosowe w pełnym asortymencie rozmiarowym.

Pytanie nr 43 dotyczy wzoru umowy §7 ust. 2 pkt a)

Wykonawca prosi o zmianę zapisu na :

„w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto danego pakietu, określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostaw częściowych danego pakietu”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisu w w/w zakresie.

Pytanie nr 44 dotyczy wzoru umowy §7 ust. 2, punkt b)

Wykonawca prosi o zmianę zapisu na:

„w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy dotyczącego pakietu, na którego przedmiot umowy została złożona reklamacja, za każdy dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisu w w/w zakresie.

Pytanie nr 45 dotyczy Pakietu nr 11, poz. 1, 6, 7, 8, 11, 12

Wykonawca prosi o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 46 dotyczy Pakietu nr 12, poz. 1-2

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie fartuchów typu SMMMS.

Odpowiedź:

Opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 47 dotyczy Pakietu nr 89, poz. 5 i 9

Wykonawca zwraca się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 48 dotyczy Pakietu nr 89, poz. 2, 3, 4, 6

Wykonawca prosi o dopuszczenie rękawic, których poziom AQL wynosi 1,0.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w rękawic.

Pytanie nr 49 dotyczy pkt VII.1.d. SIWZ

Wykonawca wnosi o skonkretyzowanie warunku udziału w postępowaniu (sytuacji ekonomicznej i finansowej) również w rozbiciu na poszczególne pakiety. Obecny zapis narusza art. 7 PZP, gdyż ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie jednakowa dla wykonawców, którzy wykażą się opłaconą polisą o wartości 200 000,00 zł i złożą ofertę na 1 pakiet jak również dla tych, którzy będą posiadali opłaconą polisę o wartości 200 000,00 zł i złożą ofertę na wszystkie pakiety.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia wyżej opisany warunek bez zmiany, gdyż jest on na poziomie umożliwiającym wystartowanie podmiotom o różnym potencjale.

Pytanie nr 50 dotyczy pkt VIII.1.b. SIWZ i załącznika nr 4 do SIWZ

Wykonawca wnosi o wykreślenie postanowienia, że na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumenty dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i stosowania na terenie Polski w tym próbek (ponieważ próbka jest dokumentem (patrz. Chociażby - Sygn. akt KIO/UZP 1695/09) w rozumieniu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013.poz.231).

Zamawiający władny jest do oceny ofert tylko na podstawie dokumentów, które wykonawcy zobligowani byli złożyć do upływu terminu składania ofert. Żądanie dodatkowych dokumentów już po terminie otwarcia ofert w celu oceny czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego nie ma odniesienia w PZP, narusza wprost art. 7 PZP, doprowadza do niemożności zastosowania art. 26 ust. 3 PZP oraz może doprowadzić, ze względu na nieostrość zapisu do arbitralnych rozstrzygnięć Zamawiającego.

Z ostrożności procesowej prosimy o wyjaśnienie:

w jakim konkretnie celu i na podstawie jakich obiektywnych wzorców będzie Zamawiający oceniał próbki, tym bardziej, że kryterium oceny ofert to cena 100% **oraz jakie parametry ma potwierdzać ten dokument.**

Wykonawca prosi o dookreślenie sposobu oceny ofert lub wykreślenie spornych zapisów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje wykreślenia w wyżej wymienionym zakresie. Dokumenty dopuszczające wyroby medyczne należy dostarczyć wraz z pierwszą dostawą oraz na wezwanie Zamawiającego. Dokumenty te nie podlegają ocenie a jedynie potwierdzają prawdziwość złożonego na etapie postępowania oświadczenia.

Zamawiający w rozdziale VIII SIWZ określił, że zastrzega sobie prawo do zażądania próbek w sytuacji, gdy na podstawie przedłożonych dokumentów (katalogów, folderów, opisów technicznych, itp.) nie będzie można stwierdzić, czy dany wyrób medyczny odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ np.

czy kaniula z pakietu nr 1 poz. 1 posiada samo-domykający się korek portu bocznego, czy jest kolorowe oznaczenie kaniuli, czy na opakowaniu jednostkowym jest fabrycznie nadrukowana prędkość przepływu, itd.

Pytanie nr 51 dotyczy §5 ust.3 wzoru umowy

Biorąc pod uwagę dobre obyczaje kupieckie, zasady współzycia społecznego oraz o spójność z **§5 ust.6 (uznanie reklamacji)** Wykonawca prosi o następującą modyfikację i dopisanie na końcu zdania:

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy, że dostarczony przedmiot umowy nie posiada oznakowania określonego w §5 ust. 1, stwierdzenia braków ilościowych w stosunku do zamówienia częściowego, niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym lub innych wad – Zamawiający zgłosi to Wykonawcy, który nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia uzupełni braki ilościowe w przedmiocie umowy lub wymieni przedmiot umowy na nieposiadający wad **w przypadku uznania reklamacji.**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza wyżej opisanej modyfikacji.

Pytanie nr 52 dotyczy §7 ust.2 wzoru umowy

Zgodnie z art. 353.1 k.c. zasady współzycia społecznego ograniczają swobodę kontraktową, zaś art. 58 §2 k.c. wyznacza granice dopuszczalnej treści czynności prawnej. Jeżeli zastrzeżona w umowie wysokość odsetek jest rażąco wysoka, to już tylko z tego powodu jest sprzeczna z zasadami współzycia społecznego, a w konsekwencji w tym zakresie ta część umowy może być uznana za nieważną. Nadto naliczanie tak wysokich kar umownych wypełnia przesłankę określoną w art. 484 §2 k.c. Prosimy o zmianę §7 ust.2 wzoru umowy na następujący:

2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto **danej dostawy częściowej**, za każdy dzień **zwłoki** w realizacji dostaw częściowych danego pakietu z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto **danej dostawy reklamacyjnej**, dotyczącego pakietu, na którego przedmiot umowy została złożona reklamacja, za każdy dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

c) w wysokości **5% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części danego pakietu**, określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy na określony pakiet, bez wypowiedzenia przez Zamawiającego z **winy** Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza wyżej opisanej modyfikacji.

Pytanie nr 53 dotyczy §4 ust.5 wzoru umowy

Prosimy o następującą modyfikację:

5. Niepełna realizacja zamówienia ze strony Zamawiającego nie narusza postanowień niniejszej umowy i nie rodzi jakiegokolwiek odpowiedzialności ze strony Zamawiającego **pod warunkiem jednak, że niezrealizowana ilość asortymentu nie będzie większa niż 20% wartości umowy.**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza wyżej opisanej modyfikacji.

Pytanie nr 54

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw częściowych do 4 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 55

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu w §5 ust. 3 do 5 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 20 – termin określony w §5 ust. 3 został wydłużony do 5 dni roboczych.

Pytanie nr 56

Wykonawca prosi o modyfikację §7 ust. 2a) wzoru umowy w następujący sposób:

„w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia jednostkowego, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy częściowej”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza wyżej opisanej modyfikacji.

Pytanie nr 57

Wykonawca prosi o modyfikację §7 ust. 2b) wzoru umowy w następujący sposób:

„w wysokości 0,1% wartości brutto reklamowanego przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza wyżej opisanej modyfikacji.

Pytanie nr 58

Wykonawca prosi o modyfikację §7 ust. 2c) wzoru umowy w następujący sposób:

„w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części danego pakietu, w przypadku rozwiązania umowy na określony pakiet, bez wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza wyżej opisanej modyfikacji.

Pytanie nr 59

Wykonawca prosi o modyfikację §7 ust. 2e) wzoru umowy w następujący sposób:

„w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy, w przypadku niezrealizowania w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do podjęcia działania”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza wyżej opisanej modyfikacji.

Pytanie nr 60

Wykonawca prosi o zmodyfikowanie zapisu §3 ust. 2 wzoru umowy poprzez wykreślenie zdania

„Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu uwzględniającego zmianę stawki VAT.” i dodanie sformułowania: *„Zmiana ta nie wymaga zawierania przez Strony pisemnych aneksów do umowy”*?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza wyżej opisanej modyfikacji.

Pytanie nr 61

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu §4 ust. 4 wzoru umowy poprzez dodanie zdania o następującym brzmieniu „z zastrzeżeniem, że ograniczenie zamówień asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy nie będzie większe niż 20% wartości/ ilości asortymentu wskazanego w niniejszej umowie.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmodyfikowania zapisu §4 ust.4 wzoru umowy.

Pytanie nr 62

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu §5 ust. 5 wzoru umowy poprzez dodanie na zakończenie sformułowania „lub wyspecjalizowanego przewoźnika”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu §5 ust.5 wzoru umowy w wyżej określony sposób. Wobec powyższego zapis §5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. *W przypadku konieczności uzupełnienia braków ilościowych, wymiany przedmiotu umowy na nieposiadający wad, Wykonawca dokona tych czynności na własny koszt i ryzyko – swoimi środkami transportu lub wyspecjalizowanego przewoźnika.*

Pytanie nr 63

Wykonawca prosi o wykreślenie zapisów §5 ust. 8 wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wykreśla zapisów określonych w §5 ust.8 wzoru umowy.

Pytanie nr 64

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu §4 ust. 11 wzoru umowy poprzez dodanie po słowach „transportu Wykonawcy” sformułowania „lub wyspecjalizowanego przewoźnika”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu §4 ust.11 wzoru umowy w wyżej określony sposób. Wobec powyższego zapis §4 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

11. *Dostawa przedmiotu umowy dokonywana będzie środkami transportu Wykonawcy lub wyspecjalizowanego przewoźnika na jego koszt i ryzyko.*

Pytanie nr 65

Wykonawca prosi o modyfikację §7 ust. 3 wzoru umowy w następujący sposób:

„Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Pytanie nr 66

Wykonawca prosi o wykreślenie zapisów §9 ust. 3 wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje w/w wykreślenia.

Pytanie nr 67

Prosimy o wykreślenie zapisów §9 ust. 5 wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje w/w wykreślenia.

Pytanie nr 68

Prosimy o modyfikację §11 wzoru umowy w następujący sposób: *„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na taką modyfikację paragrafu, jednakże sam modyfikuje zapisy w §11 w sposób następujący, iż wykreśla ze zdania 4 słowa: *„ ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata”*

I otrzymują brzmienie w całości:

„Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiegokolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania”

Pytanie nr 69 dotyczy Pakietu nr 38, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji noża grotowego do paracentezy o szarości ostrza 1,5mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 70 dotyczy Pakietu nr 38, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji noża o typu SLIT obustronnie ostrzony (Intrepid) o szerokości ostrza 2,2mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 71 dotyczy Pakietu nr 38, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji noża CRESCENT o szerokości ostrza 2,3mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 72 dotyczy Pakietu nr 38:

W związku z faktem, iż Zamawiający składa zapotrzebowanie na noże mikrochirurgiczne w ilości, która nie jest wielokrotnością liczby 6, natomiast oferowane przez naszą firmę noże w pakiecie 38 są

sprzedawane przez producenta w opakowaniach handlowych zawierających 6 sztuk i nie istnieje możliwość sprzedaży pojedynczych sztuk, **czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie odpowiednio dla pozycji nr 1: 996 sztuk; pozycji nr 2: 798 sztuk; pozycji nr 3: 396 sztuk przedmiotowego asortymentu?**

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zgadza się.

Pytanie nr 73 dotyczy Pakietu nr 39, poz. 1:

W związku z faktem, iż Zamawiający składa zapotrzebowanie na akcesoria do fakoemulsyfikacji w ilości, która nie jest wielokrotnością liczby 6, natomiast akcesoria oferowane przez naszą firmę w pozycji 1 są sprzedawane przez producenta w opakowaniach handlowych zawierających 6 sztuk i nie istnieje możliwość sprzedaży pojedynczych sztuk, **czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 198 sztuk przedmiotowego asortymentu?**

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zgadza się.

Pytanie nr 74 dotyczy Pakietu nr 39, poz. 2:

Czy w związku z zakończonym procesem produkcji przez producenta wymaganych kabli do diatermii jednorazowego użytku, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji **kabli do diatermii wielokrotnego użytku?** Jeśli tak to prosimy o podanie wymaganej ilości sztuk. Proponowana przez Wykonawcę ilość to 15 sztuk, która w pełni odpowiada wymaganiom SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie nr 75 dotyczy pakietu nr 39:

Czy Zamawiający wymaga by oferowane w ww. pakiecie akcesoria były oryginalne, dedykowane do aparatu Infiniti?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby akcesoria były kompatybilnych z aparatem Infiniti.

Pytanie nr 76 dotyczy Pakietu nr 12, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z ręczniczkami włókninowymi ?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje asortymentu takiego jak w opisie SIWZ.

Pytanie nr 77 dotyczy Pakietu nr 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C w rozmiarze 105 x 183 cm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści taką osłonę.

Pytanie nr 78 dotyczy Pakietu nr 16, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 15 cm x 250 cm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści taką osłonę.

Pytanie nr 79 dotyczy wzoru umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 80 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 2 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Ponadto strony mogą wyjątkowo zmienić ceny w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?*

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na dopisanie zadania o wyżej określonej treści.

Pytanie nr 81 dotyczy wzoru umowy

Zważywszy na treść § 4 ust. 5 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa minimalnej ilości jaką na pewno zamówi.

Pytanie nr 82 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 lit a) i b) wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na powyższą modyfikację.

Pytanie nr 83 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 lit. a) wzoru umowy słowa „0,1% wynagrodzenia brutto danego pakietu określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy” zostały zastąpione słowami „0,1% wartości brutto przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na powyższą modyfikację.

Pytanie nr 84 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 lit. b) wzoru umowy słowa „0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy dotyczącego pakietu, na którego przedmiot została złożona reklamacja” zostały zastąpione słowami „0,1% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, na który została złożona reklamacja”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na powyższą modyfikację.

Pytanie nr 85 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 lit. c) wzoru umowy słowa „10% wynagrodzenia brutto danego pakietu, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy” zostały zastąpione słowami „10% niezrealizowanej wartości brutto danego pakietu określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na powyższą modyfikację.

Pytanie nr 86 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 2 lit. a) lub b), Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy i będzie uprawniony do rozwiązania umowy, jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na powyższą modyfikację.

Pytanie nr 87 dotyczy Pakietu nr 72, poz. 8, 9, 10, 12 oraz Pakietu 73, poz. 1.

Wykonawca prosi o podanie rodzaju technologii pomiaru SpO2 w poszczególnych pozycjach, celem dopasowania odpowiednich czujników. Możliwe rodzaje :

- Nellcor
- Masimo LNCS
- Masimo LNOP

Odpowiedź:

Dla pozycji 8,9,10 - czujnik Masimo LNCS

Dla pozycji 12 – czujnik Nellcor

Pytanie nr 88 dotyczy Pakietu nr 72, poz. 7.

Wykonawca prosi o dopuszczenie czapeček jednorazowego użytku do Babyflow, pakowanych po 5 szt., z zapewnieniem pełnej ilości, jaką potrzebuje Zamawiający, czyli 20 szt.

Odpowiedź:

W pakiecie 72 poz. 7 nie ma w/w asortymentu. Jeżeli chodziło Wykonawcy chodziło o pakiet nr 121 poz. 7 to Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 89 dotyczy Pakietu nr 72, poz. 15.

Wykonawca prosi o dopuszczenie akcesoriów do przezskórnego monitorowania TPO2 / TPCO2 w składzie:

- zestaw montażowy do czujników (elektrod) tpcO2 i tpcCO2 oraz
- opakowanie(tj. 12 szt.) gazu kalibracyjnego do tpcO2 i tpcCO2

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza akcesoria do przezskórnego monitorowania TPO2 / TPCO2 w/w składzie.

Pytanie nr 90 dotyczy Pakietu nr 117, poz. 1, 2, 8.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy zestaw i akcesoria wymienione w powyższych pozycjach mają być wielokrotnego użytku

Odpowiedź:

Zestaw i akcesoria wymienione w pakiecie nr 117 mają być wielokrotnego użytku.

Pytanie nr 91 dotyczy Pakietu nr 76, poz. 1.

Wykonawca prosi o wydzielenie pozycji 1 do odrębnego pakietu, celem umożliwienia zaoferowania produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pytanie nr 92 dotyczy Pakietu nr 3

Czy zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści bezpieczne kaniule wykonane z teflonu w rozmiarach:

- 0,6 – 0,9 22G dł. 25 mm, przepływ 36 ml/min
- 0,8 – 1,1 20G dł. 32 mm, przepływ 60 ml/min
- 1,0 – 1,3 18G dł. 45 mm, przepływ 90 ml/min
- 1,2 – 1,5 17G dł. 45 mm, przepływ 125 ml/min
- 1,4 – 1,7 16G dł. 45mm, przepływ 180 ml/min
- 1,6 – 2,1 14G dł. 45 mm, przepływ 270 ml/min

- z wyjątkowo cienką ścianką,
- kontrastujące w rtg,
- z zastawką silikonową, portem bocznym
- z samo domykającym się korkiem portu bocznego
- chroniącą przed wypływem krwi i zachlapaniem
- chroniącą przed zakłuciem

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie nr 93

Czy zamawiający w pakiecie nr 21 dopuści MINI SPIKE bez zastawki z standardowym filtrem infuzyjnym 0,45 i oznaczeniem kolorystycznym – zielonym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie nr 94

Czy zamawiający w pakiecie nr 75 wydzieli do osobnego pakietu pozycję nr 2 i 3.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pytanie nr 95

Czy zamawiający w pakiecie nr 5 pozycji nr 2 dopuści igłę do nakłuc lędźwiowych w rozmiarze 22G 0.7 x 50 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie nr 96

Czy zamawiający w pakiecie nr 5 pozycji nr 4 dopuści igłę do nakłuc lędźwiowych w rozmiarze 19G x 75 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie nr 97

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji Wykonawca wnosi o wprowadzenie w par. 5 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w §5 ust. 6 wzoru umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Pytanie nr 98

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 6 ust 2 a, b

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

a) w wysokości 0,1% wartości dostawy której dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostaw częściowych danego pakietu, jednak nie więcej niż 10% wartości dostawy, której dotyczy opóźnienie

b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy dotyczącego pakietu, na którego przedmiot umowy została złożona reklamacja, za każdy dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy dotyczącego pakietu, na którego przedmiot umowy została złożona reklamacja

Odpowiedź:

§6 nie mówi o karach umownych. Zamawiający nie dokonuje modyfikacji w wyżej opisanym zakresie.

Pytanie nr 99

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu w par 11

„Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata.”

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie nr 100 dotyczy wzoru umowy

Zgodnie z § 2 ust. 2 wzoru umowy Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania terminu obowiązywania umowy w przypadku niezrealizowania jej pod względem ilościowym w obowiązującym terminie umowy.

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, że przedłużenie okresu realizacji nie może być dłuższe niż 4 miesiące od dnia zakończenia umowy. W przypadku nie wyrażenia zgody, prosimy o podanie na jaki okres Zamawiający zamierza przedłużyć umowę, gdyż ma to znaczący wpływ na wycenę.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na doprecyzowanie, że przedłużenie okresu realizacji nie może być dłuższe niż 4 miesiące od dnia zakończenia umowy.

Pytanie nr 101 dotyczy wzoru umowy

Zgodnie z § 7 wzoru umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi.

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu § 7 na następujący:

w zakresie pkt. a) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto niezrealizowanej w terminie dostawy asortymentu w zakresie danego pakietu, określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostaw częściowych danego pakietu z zaznaczeniem ,że kara nie może być mniejsza niż 10 zł a każdy dzień opóźnienia.

w zakresie pkt. b) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto wadliwego asortymentu w zakresie danego pakietu, określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej wadliwego asortymentu z zaznaczeniem ,że kara nie może być mniejsza niż 10 zł a każdy dzień opóźnienia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej opisaną modyfikację.

Pytanie nr 102

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 15, poz. 1:

Zestaw serwet do zabiegów na stopie/dłoni. Skład zestawu: min. 1 serweta 320 x 200 z samouszczelniającym się otworem elastycznym o śr. 3,5 cm, 1 serweta na stolik Mayo o wym. 80 x 140 cm w formie worka złożonego teleskopowo Zestaw owinięty w serwetę na stolik narzędzi o wym. 150x190 z dodatkowym elementem chłonnym o wym. 65 x 190 cm.

Serwety wykonane z min. 2 warstw (folia polietylenowa + włóknina o min. gramaturze 60,5. Materiał musi spełniać wymogi normy EN13795 cz,1-3

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu serwet.

Pytanie nr 103

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 15, poz.2 Zestaw serwet jałowych do zabiegów na kończynie. Skład zestawu: 1 serweta o wym. 200 x 320 cm z otworem elastycznym samouszczelniającym, o śr. 6x8 cm oraz dołączonym do zestawu taśmy typu rzep do mocowania kabli i drenów;1 osłona na kończynę w formie worka 33 x 80 cm 1 serweta. wym. 150 x 200 cm; Osłona na stolik Mayo o wym. min. 80 x 140 cm, składana teleskopowo , 2 taśmy samoprzylepne o wym. 10 x 50 cm; Zestaw owinięty w serwetę o 150x200 na stolik z narzędziami;. 2 ręczniki celulozowe o wymiarach 30 x 30 cm. Zestaw wykonany z włókniny min. 3-warstwowej o gramaturze 76 g/m2 spełniający wymogi normy EN 13795 cz. 1-3.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

Pytanie nr 104

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 15, poz. 3 zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 66g/m2 i nieprzemakalności pow.900cmH20, skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu.

Pytanie nr 105

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie w 15, poz. 4 serwety zabiegowej ułożeniu ginekologicznym o wym. min. 230 x 260 cm z otworem samoprzylepnym na jamę brzuszną o wym. 25 x

30 cm i nieprzylepnym otworem 9x12 cm na krocze , serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gr.66g/m² lub trójwarstwowego o gramaturze 76g/m².i absorpcji min.400ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozmiary wykonane z materiału trójwarstwowego.

Pytanie nr 106

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 15, poz. 9 zestaw serwet podstawowych wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 66g/m² i nieprzemakalności 900cmH₂O. Skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu.

Pytanie nr 107

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 15, poz. 13 Przylepiec typu” rzep” - taśma samoprzylepna o wymiarach 2 x 22 cm do mocowania drenów i kabli do obłożenia. Pakowana pojedynczo. Jałowa.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w wymiary.

Pytanie nr 108

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 15, poz.16 serwety o min. wymiarach 200x320 cm z otworem 12x20cm otoczonym taśmą lepną, do zestawu dodany uchwyt typu rzep do dowolnego umiejscowienia na serwecie. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 66g/m² lub włókniny typu SMS z dodatkową warstwą chłonną w polu krytycznym o gramaturze 157g.m². pozostały skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga tkaninę trójwarstwową.

Pytanie nr 109

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 15, poz.17 serwety 200 x 320 cm, z otworem 30x30, samoprzylepnym, do zestawu dodane dwie kieszenie samoprzylepne do dowolnego umiejscowienia na obłożeniu. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 66g/m² lub włókniny typu SMS z dodatkową warstwą chłonną w polu krytycznym o gramaturze 157g.m². pozostały skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 110

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 15, poz. 18 serwety do artroskopii kolana o dwoma otworami samouszczelniającymi się o wymiarze 6x8cm i workiem do zbiórki płynów z zaworem spustowym i drenem 130cm, na serwecie umocowany uchwyt do mocowania kabli i drenów. Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w serwety.

Pytanie nr 111

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 15, poz.19 zestaw do zabiegów otolaryngologicznych wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 66g/m² i nieprzemakalności 900cmH₂O. Skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu.

Pytanie nr 112

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 15, poz. 20 serwety do cięcia cesarskiego o wymiarach 200x320cm z torbą na płyny oraz z oknem wypełnionym folią.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety.

Pytanie nr 113

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 15, poz. 20 serwety dla noworodka o wymiarach 80x70cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety.

Pytanie nr 114

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 15, poz. 21 serwety y do zabiegów okulistycznych wykonanej z włókniny typu SMS o wymiarze 150x150cm z otworem 10x10cm z folią chirurgiczną, kieszenią na płyny oraz kształtką dostosowującą serwetę do kształtu twarzy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety.

Pytanie nr 115

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 15, poz. 22 i 23, 31 serwet operacyjnych wykonanych z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 66g/m² i nieprzemakalności 900cmH₂O.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pozycji 22 i 23, nie dopuszcza w poz. 31.

Pytanie nr 116

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 15, poz. 32 podkład chłonny, nieprzemakalny 60x90cm zamiast 55x90cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie nr 117

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 15, poz.32 serwety dla noworodka 70x80cm zamiast 85x90cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w serwety.

Pytanie nr 118

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 15, poz.34 kleszczyki plastikowe, proste o wymiarze 19cm zamiast 20cm, pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w produkty.

Pytanie nr 119

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w pakiecie 15, poz.35 zbiornika na płyny o wymiarach 50x50cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie nr 120

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 15, poz.37 serwety z wbudowanymi osłonami na nogi o wym. min. 250 x 280 cm z samoprzylepnym otworem na okolice krocza 9x12cm. Wokół pola operacyjnego ja i na całej powierzchni obłożenia warstwa chłonna o gramaturze 66g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane serwety.

Pytanie nr 121

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 12, poz.1 i 2 Fartuchów pakowanych bez ściereczek, ściereczki dodatkowo w osobnym opakowaniu wycenione łącznie z fartuchami. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane fartuchy.

Pytanie nr 122 dotyczy Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule 16 G z przepływem min. 200 ml/min przy zachowaniu pozostałych SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie nr 123 dotyczy Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kaniule 24 G z przepływem min. 23ml/min przy zachowaniu pozostałych SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie nr 124 dotyczy Pakiet 4, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny z e skalą co 0,025ml przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie nr 125 dotyczy Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę motylek z kolorowymi, transparentnymi skrzydełkami w opakowaniu folia – papier przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie nr 126 dotyczy Pakiet 6, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze igłowe 1,8 lub 2,4 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie nr 127 dotyczy Pakiet 8, pozycja 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi z biureta 150 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie nr 128 dotyczy Pakiet 18, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zatyczek uniwersalnych, gładkich? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie ww. pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SIWZ oraz nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pytanie nr 129 dotyczy Pakiet 18, poz. 24

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 150ml lub 300ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie nr 130 dotyczy Pakiet 18, poz. 28

Czy Zamawiający dopuści sondę z zatyczką pakowaną oddzielnie przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie nr 131 dotyczy Pakiet 35 pozycja 4-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mankietów do mierzenia ciśnienia w ciemnych kolorach przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 132 dotyczy Pakiet 22, pozycja 1-9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników wykonanych z PS przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie nr 133 dotyczy Pakiet 65, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe o wymiarach 26x76mm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści w/w produkt.

Pytanie nr 134 dotyczy Pakiet 65 pozycja 8

Czy Zamawiający pisząc nakłuwacze do testów alergicznych miał na myśli lancety do testów alergologicznych?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 135 dotyczy Pakiet 101, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści matę klejącą zatrzymującą zanieczyszczenia (30 listków w opakowaniu) z jednoczesnym odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie nr 136 dotyczy Pakiet 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 90mm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w igły.

Pytanie nr 137 dotyczy Pakiet 12, pozycja 1,2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny typu SSMMS?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie nr 138 dotyczy Pakiet 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny o gramaturze 45g/m² i wzmocnieniami o gramaturze 28g/m² co daje łączna wartość wyższą od wymaganej przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie nr 139 dotyczy Pakiet 13

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny o gramaturze 70g/m² i wzmocnieniami o gramaturze 28g/m² co daje łączna wartość wyższą od wymaganej przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie nr 140 dotyczy Pakiet 15, pozycja 8

Prosimy o wydzielenie pozycji z pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydziela w/w pozycji w pakiecie.

Pytanie nr 141 dotyczy Pakiet 15, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 90 x 120cm

2 warstwowa serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Nogawica o wym. 70x120cm wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętym brzegiem

1x Serweta urologiczo-ginek o wym.75 x 200cm

2 warstwowa z otworem w kształcie rombu o wym. 8x12cm, długość boku rombu 7cm, w bocznych częściach serwety wycięcia w kształcie półkola o promieniu 15cm Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

4 x Ręcznik do rąk 30x30cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw..

Pytanie nr 142 dotyczy Pakiet 15, pozycja 10,11,12,14,24,25,29

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydziela w/w pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 143 dotyczy Pakiet 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalną 3 częściową:

górną z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolną z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w osłonę.

Pytanie nr 144 dotyczy Pakiet 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec w rozmiarze 65x85 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie nr 145 dotyczy Pakiet 18, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 146 dotyczy Pakiet 18, pozycja 25,28,35,36,37,40

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydziela w/w pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 147 dotyczy Pakiet 18, pozycja 30-32

Czy Zamawiający dopuści zglębniki z czterema otworami bocznymi spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 148 dotyczy Pakiet 34, pozycja 1,2

Czy Zamawiający dopuści maski jałowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści maski jałowe. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 149 dotyczy Pakiet 65, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści szkiełka w rozmiarze 76mmx25mm pakowane a'50szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie nr 150 dotyczy Pakiet 65, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści stazy z możliwością dezynfekcji poprzez płukanie w niskiej temperaturze lub dezynfekcję ozonem w niskiej temperaturze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 151 dotyczy Pakiet 65, pozycja 17,18,21

Czy Zamawiający wydzielili pozycje do osobnego zadania?

Odpowiedź:

Pakiet 65 ma 16 pozycji.

Pytanie nr 152 dotyczy Pakiet 65, pozycja 20

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby golarki posiadały ostrze pokryte powłoką teflonową?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od w/w wymogu.

Pytanie nr 153 dotyczy Pakiet 89, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice gładkie z AQL=1,5, zgodność z EN 455 potwierdzona przez jednostkę niezależną i badania producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w rękawic, oczekuje produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 154 dotyczy Pakiet 89, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice bezpudrowe z teksturowane na całej powierzchni z AQL=1,5, zgodność z EN 455 potwierdzona przez jednostkę niezależną i badania producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w rękawic., zgodnie z SIWZ tekstura ma być na końcach palców.

Pytanie nr 155 dotyczy Pakiet 89, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści rękawice syntetyczne, neoprenowe? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji z pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie nr 156 dotyczy Pakiet 89, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowne po 200szt – rozmiar S-L i 180 szt. – rozmiar XL z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w pakowania.

Pytanie nr 157 dotyczy Pakiet nr 16, poz. 1


Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji jednorazowego użytku sterylnej, jednoczęściowej osłony na ramię „C” aparatu RTG. Osłona w rozmiarze 104 cm x 230 cm z rozcięciem 1370 mm i dwoma taśmami do mocowania. Pakowana w sposób zgodny z normami i wygodny dla użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie nr 158 dotyczy Pakiet nr 16, poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnej osłony na sprzęt szytej na okrągło w rozmiarze 50 x100 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie nr 159 dotyczy Pakiet nr 16, poz. 3

Wykonawca prosi Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji jednorazowej, wysokiej jakości sterylnej osłony na przewody w rozmiarze 15x220 cm, zawierającej pierścień ułatwiający zakładanie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/ produkt.

Pytanie nr 160 dotyczy Pakiet nr 92, poz. 2

Wykonawca prosi Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji fartucha w włókniny polipropylenowej z nieprzemakalnymi wstawkami z przodu i na całych rękawach w opakowaniu po 10 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie nr 161 dotyczy Pakiet nr 92, poz. 3

Wykonawca prosi Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu o szer. 59 cm, 50 mb na rolce, perforacja standardowa co 50 cm. składającego się z dwóch warstw celulozy oraz warstwy folii. Z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 70 rolek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

Pytanie nr 162 dotyczy Pakiet nr 92, poz. 4

Wykonawca prosi Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji prześcieradła w rozmiarze 80 cm x 200 cm, nieprzemakalnego z włókniny polipropylenowej laminowanej folią.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie nr 163 dotyczy Pakiet nr 11, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji czepka spełniającego wszystkie wymogi SIWZ w opakowaniu foliowym po 100szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pakowania w kartonik.

Pytanie nr 164 dotyczy Pakiet nr 11, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji czepka z włókniny polipropylenowej spełniającego wszystkie wymogi SIWZ w opakowaniu foliowym po 100szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pakowania w kartonik.

Pytanie nr 165 dotyczy Pakiet nr 11, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji czepka z włókniny polipropylenowej spełniającego wszystkie wymogi SIWZ w opakowaniu foliowym po 100szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pakowania w kartonik.

Pytanie nr 166 dotyczy Pakiet nr 11, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji czepka z włókniny polipropylenowej spełniającego wszystkie wymogi SIWZ w opakowaniu foliowym po 100szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pakowania w kartonik.

Pytanie nr 167 dotyczy Pakiet nr 11, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji fartucha spełniającego wszystkie wymogi SIWZ z rękawem ściągany mankietem z dzianiny bawełnianej. .

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Pytanie nr 168 dotyczy Pakiet nr 11, poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji jednorazowych ochraniaczy na buty włókninowo-foliowych z warstwą antypoślizgową.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Zamawiający prosi o dokonanie korekty nr sprawy w załączniku nr 4 – oświadczenie, powinno być:
6/13/ZZP/PN.

PREZES ZARZĄDU
Mariola Szulc

WICEPREZES ZARZĄDU
Krzysztof Leki